

petr

Jméno:

slanina

Příjmení:

Rodné číslo:

12.03.1978



Datum narození:

Kontaktní informace:

Místo:

07.11.2019

Datum měření:

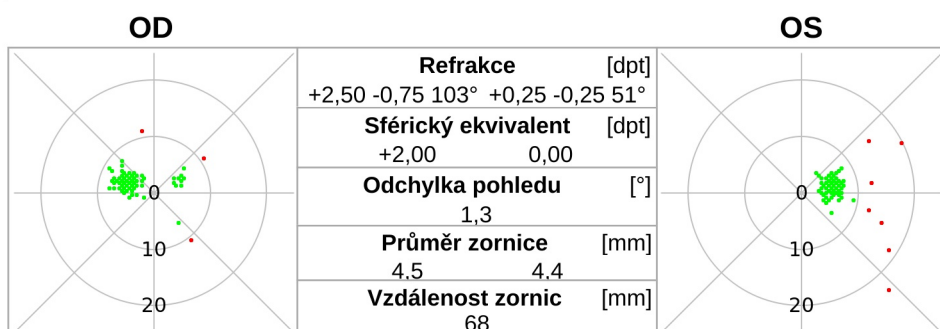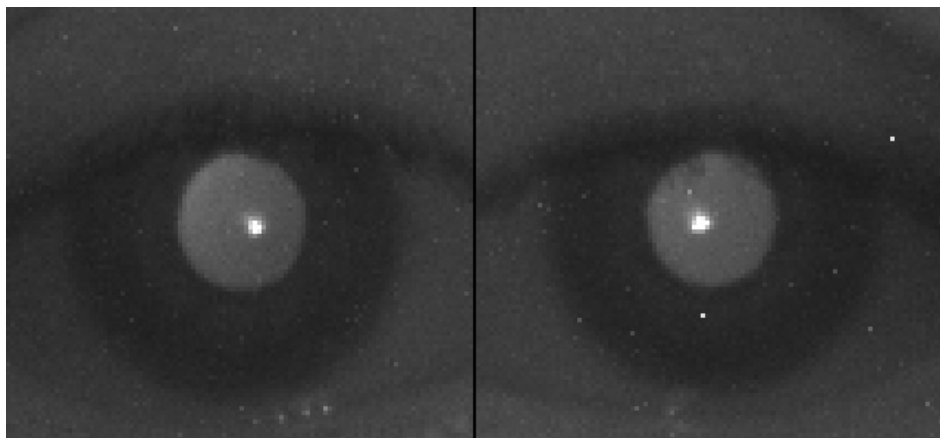

≥ 1,00 dpt

Anisometropie

Sférický ekvivalent ≥ 1,00 dpt

≥ 1,00 dpt

Astigmatismus

≥ 2,00 dpt

Hyperopie

Sférický ekvivalent ≥ 2,00 dpt

≥ 1,00 dpt

Myopie

≥ 5,0 °

Odchylka pohledu

≥ 1,5 mm

Anisokorie

ROC A, Ver. 7.1.4.0

Výsledek screeningu

Vyšetřit

Slouží pouze k měření refrakce bez rozkapání. Naměřené výsledky může hodnotit pouze oční specialista. Vyšetření by mělo být opakováno zhruba v 1/2 ročních intervalech. Děti s výsledkem "Vyšetřit podrobněji" by měly být poslány na podrobné vyšetření oftalmologem.

Refraction was measured with Plusoptix.

Check out our range of binocular autorefractors for your clinic.

www.plusoptix.com



Accurate



Award-winning



Reliable



Compatible